

# IWAKIニュース

2021 No. 11



## ウェアコーナー

- 理化学ガラス製品の製品ロゴ及び梱包仕様の変更について
- 比色式残留塩素測定器用一部製品の販売中止について
- 一部 WARE 製品の販売中止について

2021年11月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |  
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

## 仕様変更

### 理化学ガラス製品の製品ロゴ及び梱包仕様の変更について

理化学ガラス製品の製品ロゴ及び梱包仕様につき、下記の通りランニングチェンジにて変更させていただきます。

- 仕様変更詳細：別紙 仕様変更詳細をご参照ください。

## 販売中止

### 比色式残留塩素測定器用一部製品の販売中止について

比色式残留塩素測定器用一部製品につきましては、諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。

#### 1. 対象製品

2021 年総合カタログ 掲載ページ	品種コード	製品名
255	CL-DPD-501	DPD 法用粉体試薬分包タイプ(100 個入)
255	CL-DPD-503	DPD 法用粉体試薬分包タイプ(500 個入)
255	CL-TUBE-021A	角型試験管(2 本入)
255	CL-SI-CAP	角型試験管用シリコンキャップ(5 ケ入)

#### 2. 販売中止日

CL-DPD-503、CL-SI-CAP は在庫限りでの販売中止とし、

CL-DPD-501、CL-TUBE-021A は既に在庫が完売しているため、即日販売中止とさせていただきます。

代替え製品につきましては、弊社までお問い合わせください。

2021年11月吉日

## 一部 WARE 製品の販売中止について

下記一部 WARE 製品につきましては、諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。

### 1. 対象製品

2021 年総合カタログ 掲載ページ	品種コード	品名
189	S-PIPET-US2S	メスピペット(先端目盛, US 形, 穴大)ニュースタンダード 2mL
191	MS-PIPET5S	メスピペット(ショーティタイプ・普通目盛) 5mL
191	MS-PIPET10S	メスピペット(ショーティタイプ・普通目盛) 10mL
191	SC-PIPET1	培養ピペット(精密形 先端・普通兼用目盛) 1mL
198	5640FK95C	メスフラスコ(透明摺合せ栓付) 95mL
198	5640FK120C	メスフラスコ(透明摺合せ栓付) 120mL
204	TM-PIPET1AA-N	ホールピペット(アミルアルコール用) 1mL
207	B-NASUGJFK10-15	共通摺合せナス形フラスコ(茶) 10mL 15/25
207	B-NASUGJFK30-15	共通摺合せナス形フラスコ(茶) 30mL 15/25
210	D4315FK50-29	透明摺合せ梨型フラスコ 50mL 29/42
210	D4315FK100-15	透明摺合せ梨型フラスコ 100mL 15/25
210	D4315FK100-29	透明摺合せ梨型フラスコ 100mL 29/42

### 2. 販売中止日

既に在庫がすべて販売済のため、即日販売中止とさせていただきます。

理化学ガラス製品の製品ロゴ及び梱包仕様の変更の件 仕様変更詳細

【Others】  
 IWAKI news 2021年11月  
 AGCテクノグラス株式会社  
 コンシューマ本部営業部  
 サイテック営業G



弊社タイランド製の製品につきまして、以下の仕様変更をランニングチェンジで実施させて頂くことと致しましたので、お客様のお手元に一部新旧混在した仕様の製品が届くことが有りますが、いずれも製品品質上問題のない製品ですので、ご理解頂けますようお願い申し上げます。

【製品ロゴ】

変更前(旧)


ロゴ詳細は以下となります。

変更後(新)




原産国が入ります

【外箱の印刷】




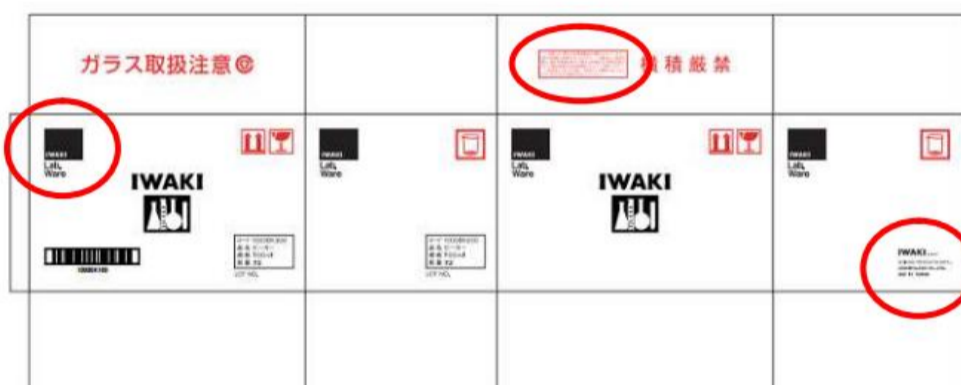


赤○部の詳細は以下となります。

変更前(旧)



変更後(新)

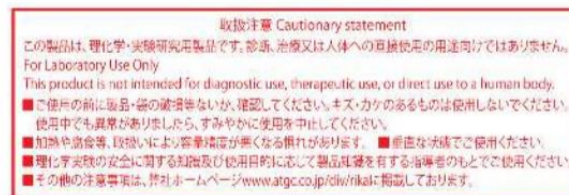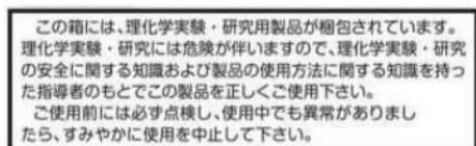

【外箱の写真】




【ガラス管の外箱及びラベルの印刷】

変更前(旧)



変更後(新)

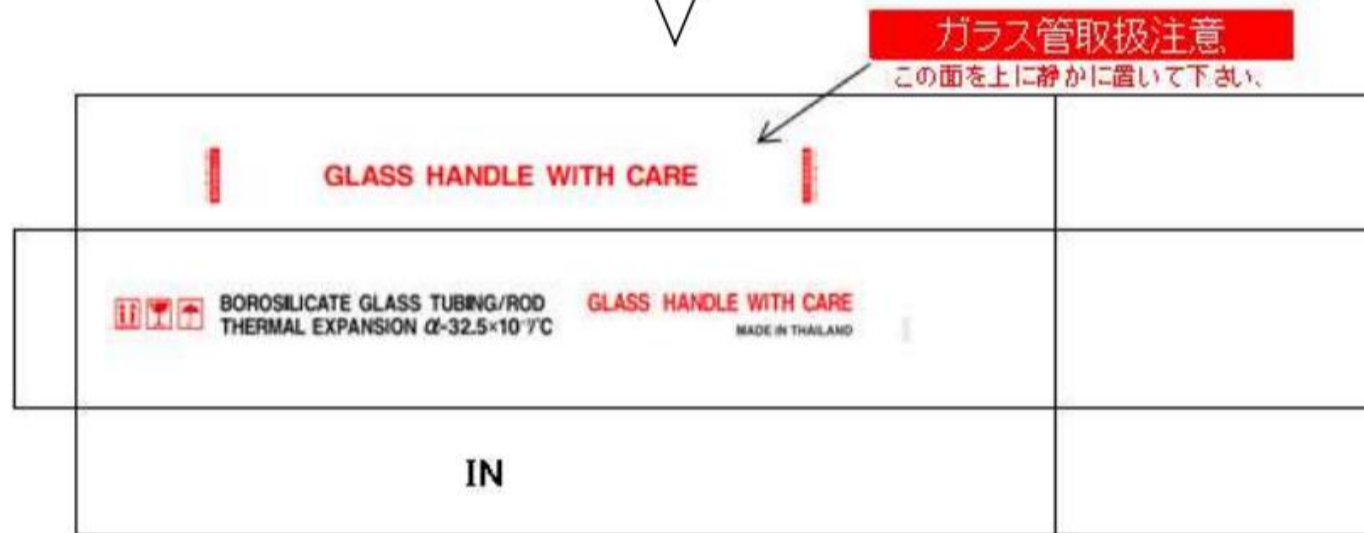

変更前(旧)



変更後(新)



以上